

С. . 1 621.752

- . . 2
- . . 3
- . . 1
- . . 4
- . . 5

1 « »

3 « »

,

2 « . - »

,

4 « »

,

⁵ Metrix Instrument Co

,

(10%


).

N ,

(1 2 . 1).

$G_T = \text{const}$

N = const.

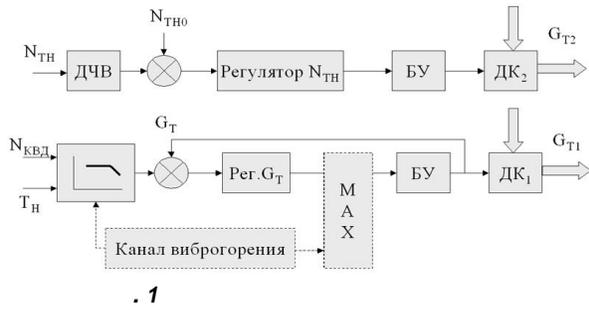

. 1

GC9125

GC9125-001,

14

1.

Profibus

(. 2)

250

15

0,5%.

5528

0,5%.

120 300

7006 800



Датчики:

- Штатные вибродатчики – 3 шт.;
- Датчик пульсаций – 1 шт.;
- Дополнительные датчики – до 10 шт.;
- Датчики частоты вращения – 3 шт.


Функции:

- измерение сигналов
- полосовая обработка
- спектральная обработка
- передача данных

Функции:

- конфигурирование GC9125
- обмен информацией
- сохранение результатов
- отображение результатов

3.


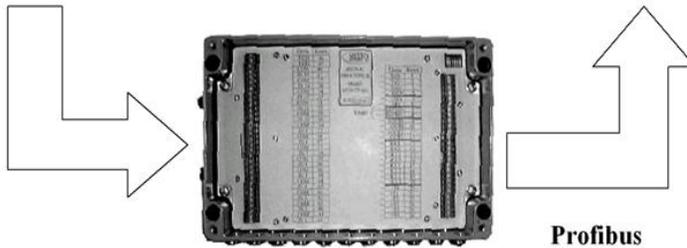


Profibus



7400...8100 / (.3,)

. 2

7987 / (133,125).

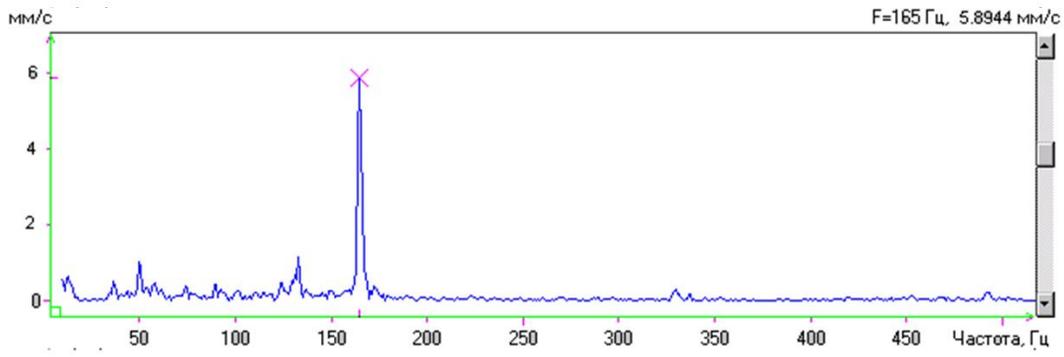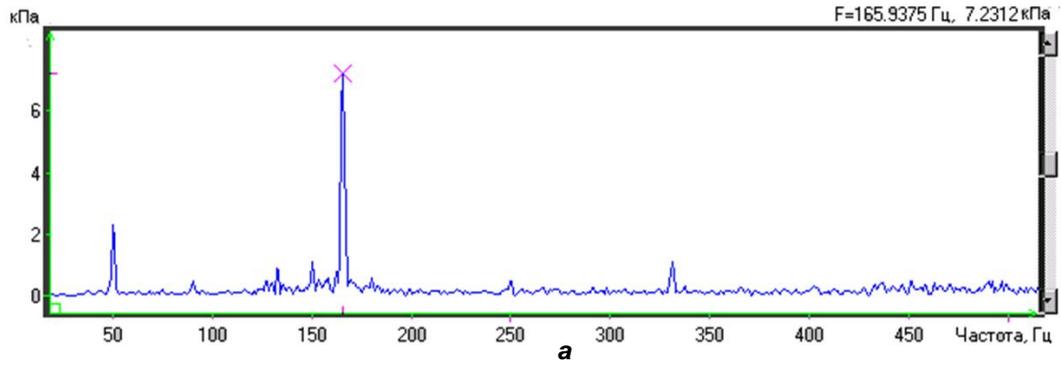

.3 () ()

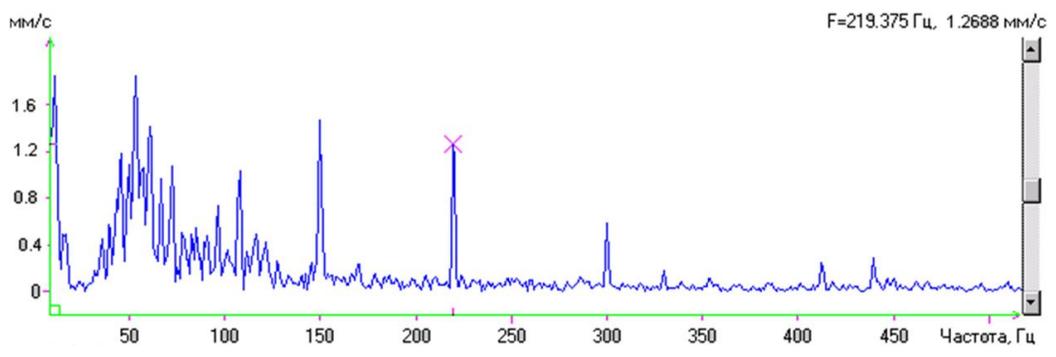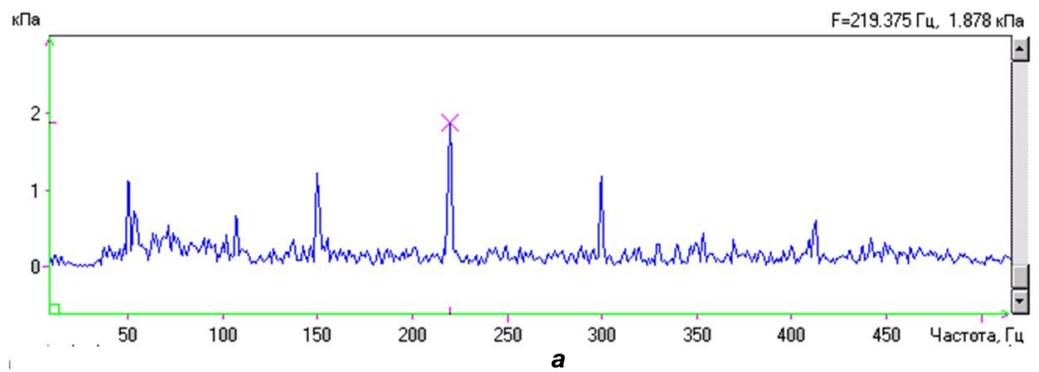

.4 () ()

7,23 165 165 5,9 /с.
 (.3,) ,

